



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl. dr. Sutomo Slawi, Telp. (0283) 491644

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Paket Pekerjaan :

Belanja Alat Kimia Darah (DAK FISIK)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	ONGKOS KIRIM (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Alat Kimia Darah-ONETECH Semi Auto Chemistry Analyze	Unit	5	55.500.000	1.400.000	278.900.000
JUMLAH						278.900.000
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah						

Slawi, 22 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

SALIYEM, S. Kep., MM.
NIP. 19710503 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Alamat : Jl. dr. Sutomo Slawi, Telp. (0283) 491644

SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan:


Belanja Alat Kimia Darah (DAK FISIK)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Alat Kimia Darah- ONETECH Semi Auto Chemistry Analyze	Unit	5	Terlampir


Slawi, 22 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

SALIYEM, S.Kep.,MM.
NIP. 19710503 199503 2 002

TAMPAK DEPAN

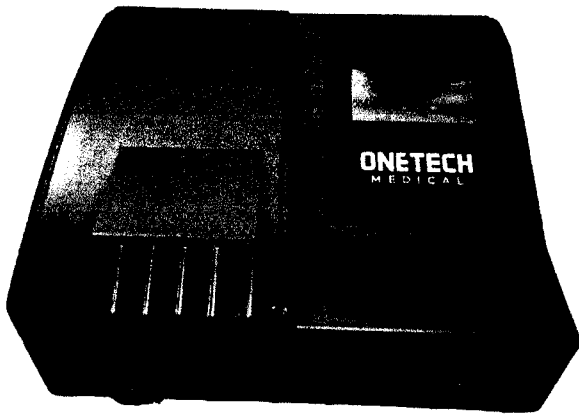


TAMPAK SAMPING KIRI

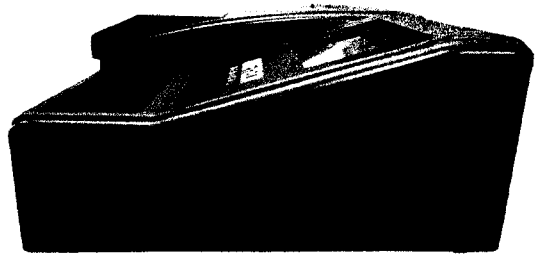

TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK BELAKANG

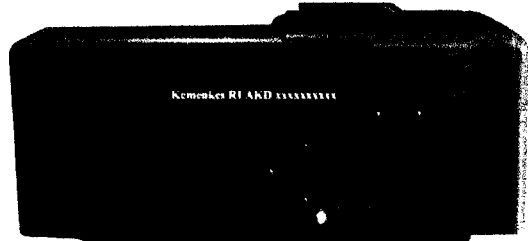

MARKING



Spesifikasi Teknis Semi Auto Chemistry Analyzer (KOMODO-200)

Model	KOMODO- 200
ReadingCuvette	Melalui <i>cell</i> dan <i>direct reading cuvette</i>
Posisi Inkubasi	20 posisi inkubasi
Sistem Fotometrik	Sumber cahaya: 6V, 10 W lampu halogen 'umur panjang'
	Filter: 340/405/492/510/546/578/620nm, 2 posisi filter lebih terbuka, +2nm <i>pass-hand</i>
	Akurasi panjang gelombang: ±2nm
Sistem Pengukuran	Rentang pengukuran: 0-2.500 O.D.
	Linearitas Fotometrik: +2% dari 0 hingga 2.000 O.D.
	Akurasi Fotometrik: +2% dari 0 hingga 2.000 O.D.
	Pelintasan < 0,005 O.D.
	Pembawaan < 1%
Suhu Inkubator	25°C, 30°C, 37°C RT
Kontrol	Presisi: +0,1°C
Tampilan	Layar sentuh berwarna yang berukuran 5 inci
Printer	Printer thermal bawaan (<i>built-in</i>)
Port Koneksi	RS-232 & USB
Catu Daya	AC 110V 60Hz / 220V 50Hz
Dimensi	34cmX38cmX18cm
Berat	8,5kg